


# Tracciabilità bombole gas medicali

## CICLO DI VITA

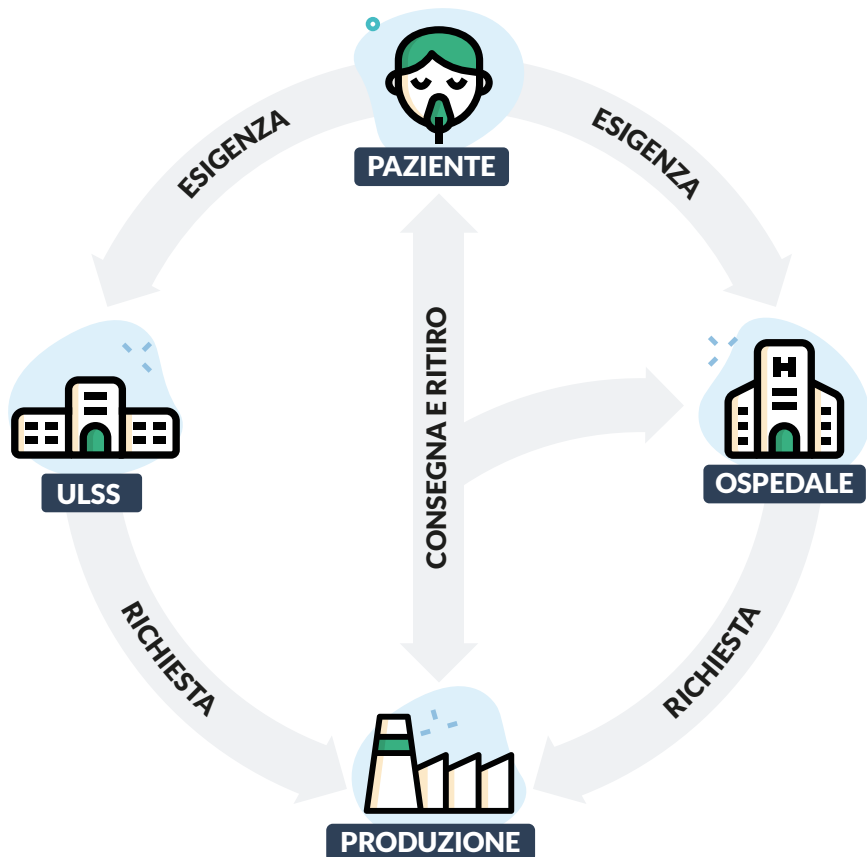

## IDENTIFICAZIONE

### BARCODE



**TIPOLOGIA**  
 O2  
**LUOGO**  
 - non disponibile -  
**MANUTENZIONE**  
 - non disponibile -

### RFID



**TIPOLOGIA**  
 O2  
**LUOGO**  
 Magazzino 3  
**MANUTENZIONE**  
 Entro 12/2021

## TECNOLOGIE A CONFRONTO

**BARCODE**  
Lettura singola




Velocità di lettura: 10 sec ~ 3 letture

Precisione



**RFID**  
Lettura massiva

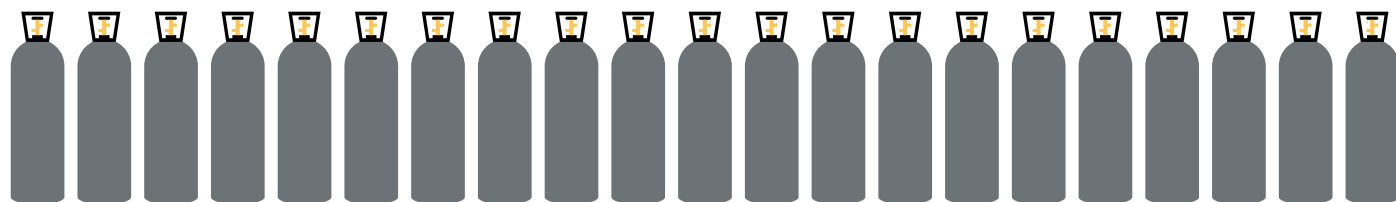

Velocità di lettura: 10 sec ~ 21 letture

Precisione

